АКТИМЕД ПЛЮС

Поставка медицинского оборудования
и расходных материалов

БИОПСИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

КАТАЛОГ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

О компании

С 1999 года Группа Компаний «Актимед Плюс» обеспечивает контракты с государственными и частными лечебно-профилактическими учреждениями медицинским оборудованием и расходными материалами.

50+
сотрудников

4
офиса
Самара
Москва
Челябинск
Санкт-Петербург

50 000+
ассортимент

20+
официальных партнеров

Мы поставляем **качественную продукцию** за минимальные для заказчика деньги.

За последние 20 лет мы оснастили более **700 больниц** и частных клиник по всей России и в странах ближнего зарубежья, поставив более **13 000 000 единиц оборудования** и расходных материалов.

О каталоге

Данный каталог включает в себя продукцию по биопсии мягких тканей, представленную компаниями Medical Device Laboratory S.r.l. (MDL) и Bard Peripheral Vascular Inc (BARD).

Если вы не нашли в каталоге то, что нужно именно Вам – отправьте запрос на почту sales@aktimed.ru, и мы обязательно что-нибудь для вас подберем!

Содержание

1. Биопсийные системы 4
Многоразовая автоматическая система PLURI-GUN 4
Многоразовая автоматическая система MAGNUM 4
Одноразовая автоматическая система AUTO-GUN 5
Одноразовая автоматическая система MONOPTY 6
Одноразовая автоматическая система Maxcore 6
2. Полуавтоматические иглы 7
Игла для гильотинной биопсии LIGHT-CUT 7
Игла со съёмной канюлей для мягкотканной биопсии LIGHT-CUT Plus 7
3. Биопсийные иглы 8
Игла Чиба для цитогистологической биопсии FRANSEEN 8
Игла Чиба для цитогистологической аспирации CYTO-CUT 9
Игла для мягкотканной биопсии FAST-CUT E 10
Игла для мягкотканной биопсии FAST-CUT M 11
Игла для мягкотканной биопсии FAST-CUT P 12
Коаксиальная проводниковая игла INTRO 13
4. Биопсийные маркеры 14
Маркеры UltraCor Twirl 14
Маркеры Gel Mark UltraCor 15
Маркеры SenoMark UltraCor MRI 15
5. Локализаторы 16
MARK 16
MARK SLIM 17
REPOMARK 18
DUALOK 18
5. Наборы для галактографии 19
GALAKIT6 19
GALAKIT Duo 19

1. Биопсийные системы

PIURI-GUN (MDL)

Многоразовая автоматическая система
для биопсии мягких тканей

- Индикаторы заряда канюли и стилета
- Легко управляема одной рукой
- Механизм последовательного
  продвижения канюли и стилета

MAGNUM (Bard)

Многоразовая автоматическая система
для биопсии мягких тканей

- Используется с биопсийными иглами Fast-Cut M
- Приведение системы в положение готовности к выстрелу
  не требует значительных физических усилий.
- Имеет две глубины проникновения – 15 мм и 22 мм.
- Мощная пружина обеспечивает высокую скорость введения иглы
  и позволяет получать образцы качественного биоптата.
- Имеется предохранитель от случайного выстрела.

AUTO-GUN (MDL)

Одноразовая автоматическая система для режущей биопсии мягких тканей

- Легковесное устройство
- Стилет имеет тройную ультра-острую заточку

- Два режима забора образца

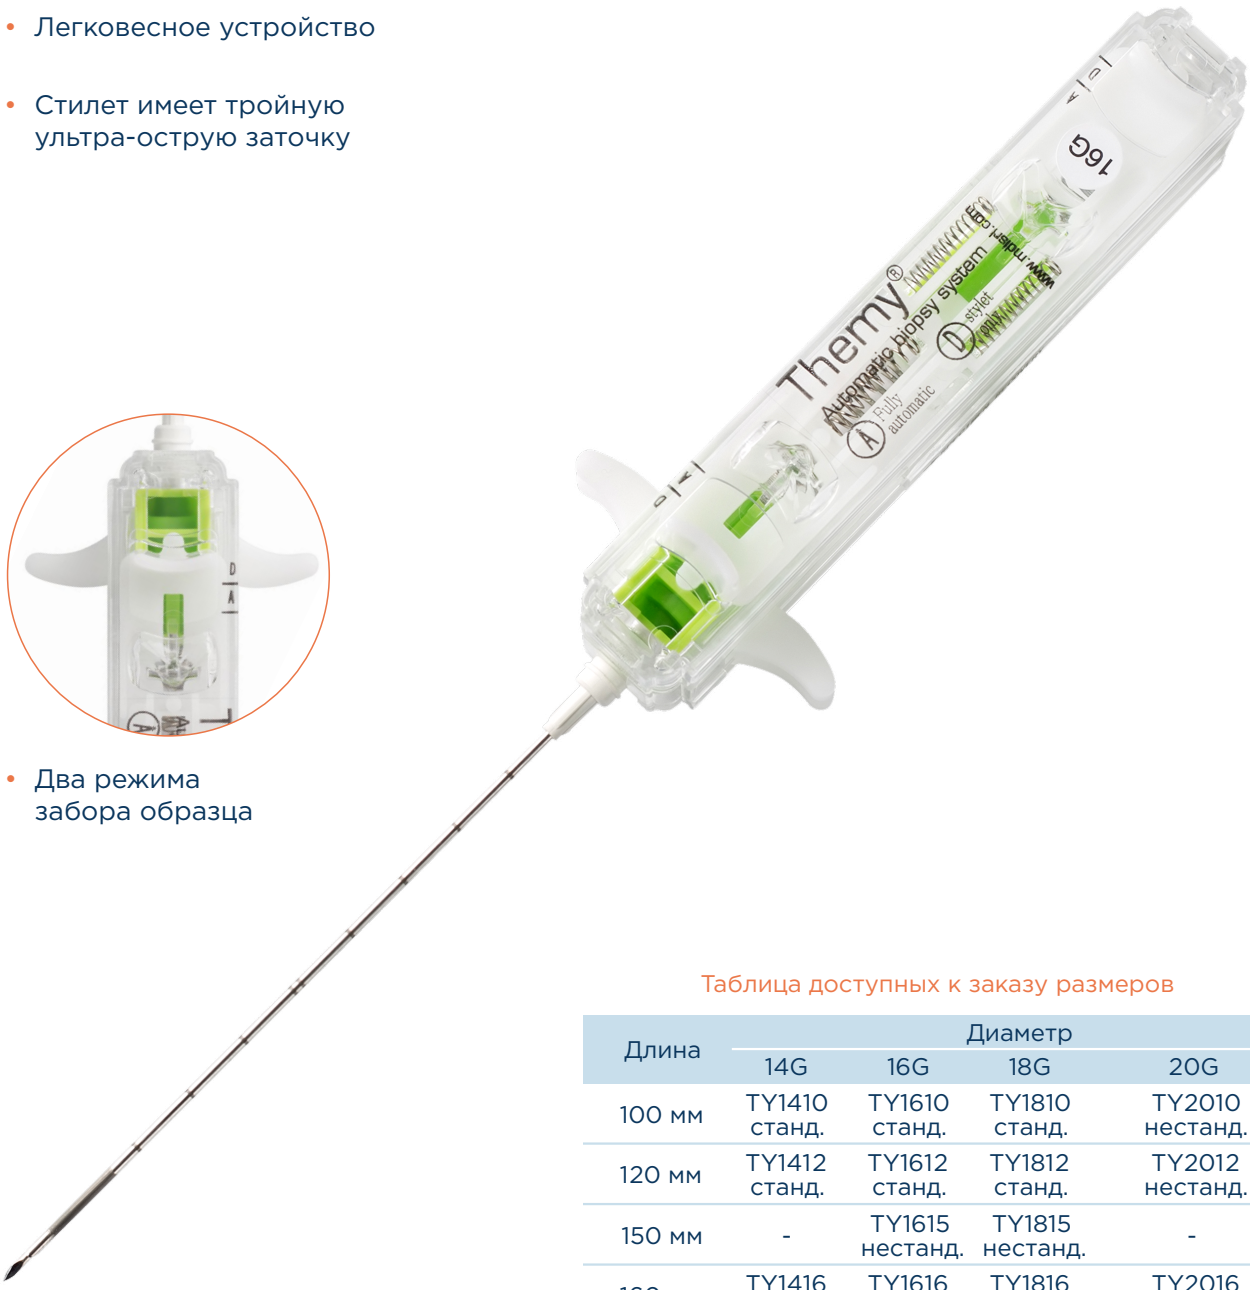

Таблица доступных к заказу размеров

Длина	Диаметр			
	14G	16G	18G	20G
100 мм	TY1410 станд.	TY1610 станд.	TY1810 станд.	TY2010 нестанд.
120 мм	TY1412 станд.	TY1612 станд.	TY1812 станд.	TY2012 нестанд.
150 мм	-	TY1615 нестанд.	TY1815 нестанд.	-
160 мм	TY1416 станд.	TY1616 станд.	TY1816 станд.	TY2016 нестанд.
200 мм	TY1420 нестанд.	TY1620 станд.	TY1820 станд.	TY2020 нестанд.
250 мм	TY1425 нестанд.	TY1625 нестанд.	TY1825 станд.	-
300 мм	-	-	TY1830 нестанд.	-

1. Биопсийные системы

MONOPTY (Bard)

Одноразовая автоматическая система для режущей биопсии мягких тканей

Предназначен для получения гистологических образцов мягких тканей высокого качества.

Оснащен поворотным механизмом взвода с двумя индикаторами.

Выпускается в двух модификациях — с глубиной среза 22 мм и 11 мм.

Таблица доступных к заказу размеров.

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	90 мм	100 мм	150 мм	160 мм	190 мм	200 мм
12	2,8	-	121210	-	121216	-	-
14	2,1	211410	121410	211416	121416	-	-
16	1,6	211610	121610	211616	121616	211620	121620
18	1,2	211810	121810	211816	121816	211820	121820
20	0,9	212010	122010	212016	122016	212020	122020

MAX-CORE (Bard)

Одноразовая автоматическая система для режущей биопсии мягких тканей

Предназначен для получения гистологических образцов мягких тканей типа печени, почки, простаты, селезенки, узлов лимфы и различных других опухолей мягких тканей.

Таблица доступных к заказу размеров.

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	100 мм	160 мм	200 мм	250 мм
14	2,1	MC1410	MC1416	-	-
16	1,6	MC1610	MC1616	-	-
18	1,2	MC1810	MC1816	MC1820	MC1825
20	0,9	MC2010	MC2016	MC2020	-

2. Полуавтоматические иглы

LIGHT-CUT (MDL)

Сверхлегкая полуавтоматическая игла для гильотинной биопсии

- Самая легковесная модель среди всех аналогичных устройств
- Управляется одной рукой
- Дополнительная эхоконтрастная насечка

Таблица доступных к заказу размеров.

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	70 мм	90 мм	100 мм	120 мм	150 мм	160 мм	200 мм	250 мм	300 мм
14	2,10	PDO1407	PDO1409	PDO1410	PDO1412	PDO1415	PDO1416	PDO1420	PDO1425	-
16	1,60	PDO1607	PDO1609	PDO1610	-	PDO1615	PDO1616	PDO1620	PDO1625	PDO1630
18	1,20	PDO1807	PD1610	PDO1810	-	PDO1815	PDO1816	PDO1820	PDO1825	PDO1830

LIGHT-CUT Plus (MDL)

Полуавтоматическая игла со съемной канюлей для мягкотканной биопсии

- Самая легковесная модель среди всех аналогичных устройств
- Управляется одной рукой
- Дополнительная эхоконтрастная насечка

Таблица доступных к заказу размеров.

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	70 мм	100 мм	150 мм	200 мм	250 мм
13	2,50	-	PD1310	-	-	-
14	2,10	PD1407	PD1410	PD1415	PD1420	PD1425
16	1,60	PD1607	PD1610	PD1615	PD1620	PD1625
18	1,20	PD1807	PD1810	PD1815	PD1820	PD1825
20	0,90	PD2007	PD2010	PD2015	PD2020	-

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

3. Биопсийные иглы

FRANSEEN (MDL)

Игла Чиба для цитогистологической биопсии фиброзных образований

- Луэр-лок разъем
- Канюля заточена по типу «Корона»
- Стоппер глубины введения

Одноразовая игла для тонкоигольной аспирационной биопсии мягкотканых масс, таких как щитовидная железа, лимфатические узлы, молочные железы и легкие.

Конструкция иглы позволяет получать образцы цилиндрической формы для гистологического анализа.

Канюля имеет сантиметровую маркировку, стоппер глубины введения в форме металлических «усиков» и прозрачный Луэр-лок разъем.

Таблица доступных к заказу размеров

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	100 мм	150 мм	200 мм
18	1,27	PEF1810	PEF1815	PEF1820
20	0,90	PEF2010	PEF2015	PEF2020
21	0,80	PEF2110	PEF2115	PEF2120
22	0,70	PEF2210	PEF2215	PEF2220
23	0,60	PEF2310	PEF2315	PEF2320

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

CYTO-CUT (MDL)

Игла Чиба для цитогистологической аспирации, инъекции, анестезии, амниоцентеза и забора хорионических ворсинок

- Луэр-Лок коннектор
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Скользящий стоппер для быстрой оценки глубины

Таблица доступных к заказу размеров

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	50 мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм	200 мм	250 мм	300 мм
17	1,40	PBQ1705	PBQ1707	PBQ1710	PBQ1712	PBQ1715	PBQ1720	PBQ1725	PBQ1730
18	1,27	PBQ1805	PBQ1805	PBQ1807	PBQ1812	PBQ1815	PBQ1820	PBQ1825	PBQ1830
19	1,10	PBQ1905	PBQ1905	PBQ1907	PBQ1912	PBQ1915	PBQ1920	PBQ1925	PBQ1930
20	0,90	PBQ2005	PBQ2005	PBQ2007	PBQ2012	PBQ2015	PBQ2020	PBQ2025	PBQ2030
21	0,80	PBQ2105	PBQ2105	PBQ2107	PBQ2112	PBQ2115	PBQ2120	PBQ2125	PBQ2130
22	0,70	PBQ2205	PBQ2205	PBQ2207	PBQ2212	PBQ2215	PBQ2220	PBQ2225	PBQ2230
23	0,60	PBQ2305	PBQ2305	PBQ2307	PBQ2312	PBQ2315	PBQ2320	PBQ2325	-
25	0,50	PBQ2505	PBQ2505	PBQ2507	PBQ2512	PBQ2515	PBQ2520	-	-

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

3. Биопсийные иглы

FAST-CUT E (MDL)

Игла для мягкотканой биопсии
к автоматической биопсийной системе Pro Mag 2.2

- Луэр-Лок коннектор на рукояти
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Скользящий маркер для быстрой оценки глубины

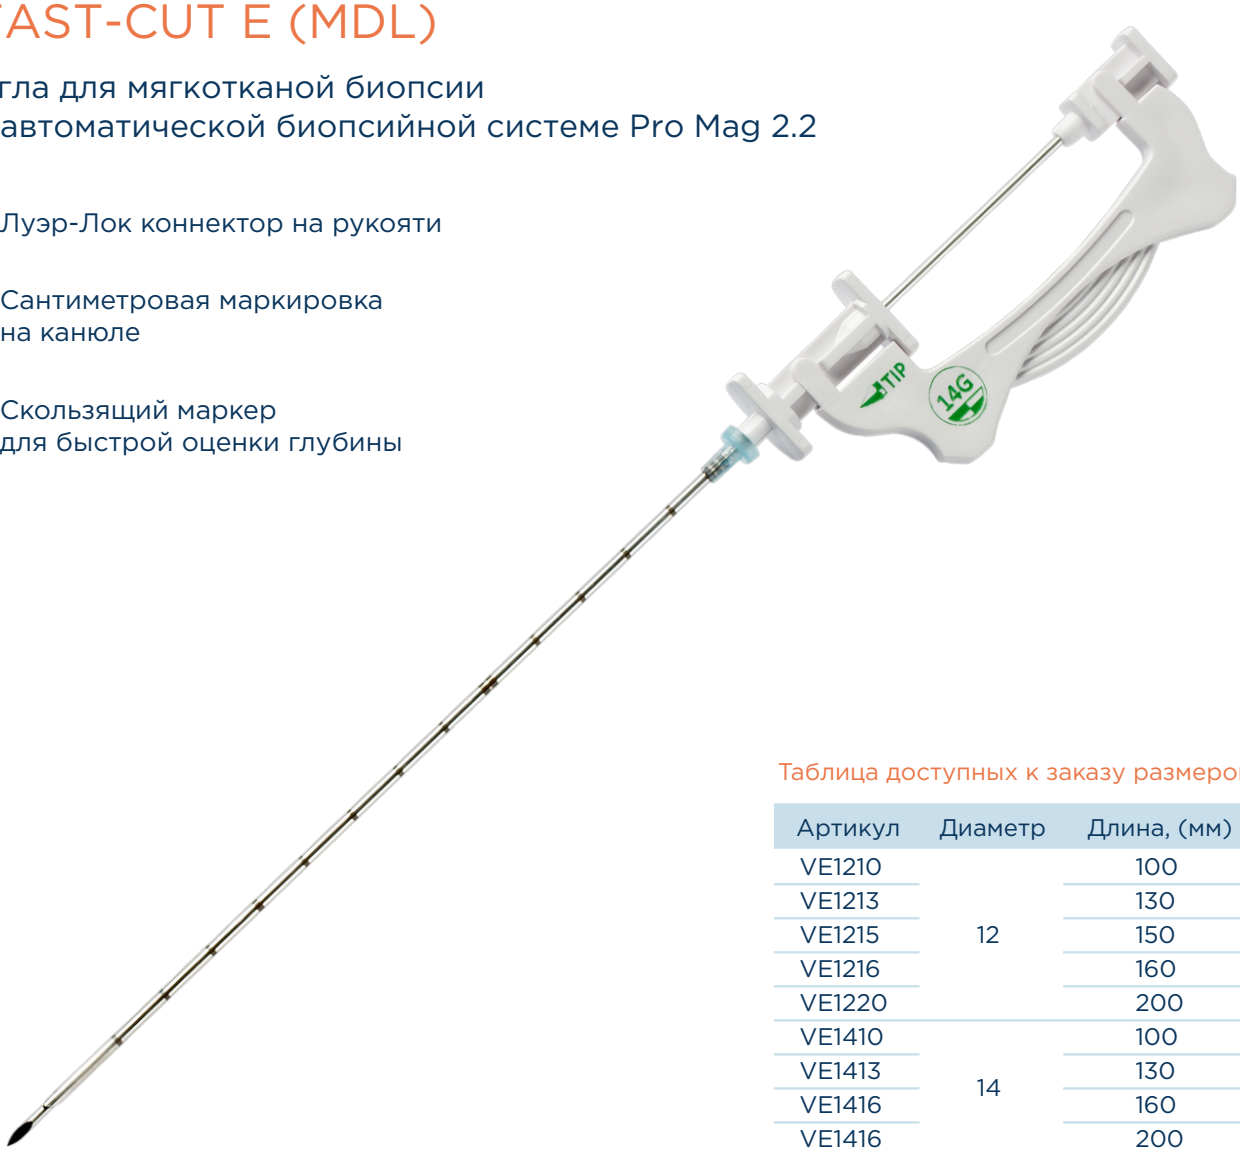

Канюля иглы выполнена из марки стали AISI304 и заточенапо Меньжини, что позволяет выполнять точный атравматичный срез столбика ткани.

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр	Длина, (мм)
VE1210	12	100
VE1213		130
VE1215		150
VE1216		160
VE1220		200
VE1410	14	100
VE1413		130
VE1416		160
VE1416		200
VE1610	16	100
VE1613		130
VE1615		150
VE1616		160
VE1620		200
VE1810	18	100
VE1813		130
VE1815		150
VE1816		160
VE1820		200
VE1825		250
VE1830		300
VE2010	20	100
VE2013		130
VE2016		160
VE2020		200

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

FAST-CUT M (MDL)

Игла для мягкотканой биопсии к автоматическим биопсийным системам MAGNUM и PLURI-GUN

- Луэр-Лок коннектор на рукояти
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Эхогенный маркер

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр, G x Длина,мм	Конфигурация
MGk11210	12 x 100	стандартная
MGk11213	12 x 130	стандартная
MGk11215	12 x 150	нестандартная
MGk11216	12 x 160	нестандартная
MGk11220	12 x 200	нестандартная
MGk11410	14 x 100	стандартная
MGk11413	14 x 130	стандартная
MGk11416	14 x 160	стандартная
MGk11420	14 x 200	стандартная
MGk11610	16 x 100	стандартная
MGk11613	16 x 130	стандартная
MGk11615	16 x 150	нестандартная
MGk11616	16 x 160	стандартная
MGk11620	16 x 200	стандартная
MGk11810	18 x 100	стандартная
MGk11813	18 x 130	стандартная
MGk11815	18 x 150	нестандартная
MGk11816	18 x 160	стандартная
MGk11820	18 x 200	стандартная
MGk11825	18 x 250	стандартная
MGk11830	18 x 300	нестандартная
MGk12010	20 x 100	нестандартная
MGk12013	20 x 130	нестандартная
MGk12016	20 x 160	нестандартная
MGk12020	20 x 200	нестандартная

Стилет иглы имеет следующие характеристики:

- тройная ультра-острая заточка для легкой пенетрации даже в фиброзные образования;
- выемка для образца длиной 20 мм с шероховатой поверхностью с целью облегчения фиксации образца.

3. Биопсийные иглы

FAST-CUT P (MDL)

Игла для мягкотканой биопсии
к автоматической биопсийной системе Pro Mag 2.5 Ultra

- Канюля имеет заточку по Меньжини
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Эхогенный маркер

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр, G x Длина,мм	Конфигурация	Артикул, вкл. коаксиальную иглу	Артикул Коаксиальной иглы	Диаметр,G x Длина,мм коаксиальной игле
MGP1410	14 x 100	стандартная	MGPC1410	PT13082	13 x 82
MGP1412	14 x 120	стандартная	MGPC1412	PT13112	13 x 102
MGP1416	14 x 160	стандартная	MGPC1416	PT13142	13 x 142
MGP1420	14 x 200	нестандартная	MGPC1420	PT13182	13 x 182
MGP1610	16 x 100	нестандартная	MGPC1610	PT15083	15 x 83
MGP1612	16 x 120	нестандартная	MGPC1612	PT15103	15 x 103
MGP1616	16 x 160	стандартная	MGPC1616	PT15143	15 x 143
MGP1620	16 x 200	стандартная	MGPC1620	PT15185	15 x 183
MGP1810	18 x 100	нестандартная	MGPC1810	PT17084	17 x 84
MGP1812	18 x 120	нестандартная	MGPC1812	PT17104	17 x 104
MGP1818	18 x 180	стандартная	MGPC1818	PT17144	17 x 144
MGP1820	18 x 200	стандартная	MGPC1820	PT17184	17 x 184
MGP1825	18 x 250	стандартная	MGPC1825	PT17234	17 x 234
MGP1830	18 x 300	нестандартная	MGPC1830	PT17284	17 x 284
MGP2010	20 x 100	стандартная	MGPC2010	PT19085	19 x 85
MGP2012	20 x 120	стандартная	MGPC2012	PT19105	19 x 105
MGP2016	20 x 160	стандартная	MGPC2016	PT19145	19 x 145
MGP2020	20 x 200	нестандартная	MGPC2020	PT19185	19 x 185

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

INTRO (MDL)

Коаксиальная проводниковая игла

- Луэр-Лок коннектор на рукояти
- Скользящий маркер для быстрой оценки глубины

- Сантиметровая маркировка на канюле

Как заказать правильный размер

Артикул составляется так: PTXXyyy

1 – зная диаметр гильотинной иглы, которую Вы будете использовать для получения образца, воспользуйтесь данной таблицей для получения необходимого диаметра коаксиальной иглы:

Диаметр гильотинной иглы	Диаметр коаксиальной иглы (параметр XX из артикула)	Внутренний диаметр коаксиальной иглы
14 G	13 G	2,17 мм
16 G	15 G	1,70 мм
18 G	17 G	1,32 мм
20 G	19 G	0,90 мм

2 - зная длину гильотинной иглы, которую Вы будете использовать для получения образца, сообщите её нашим специалистам отдела продаж для получения параметра yyy из артикула.

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

4. Биопсийные маркеры

Маркеры UltraCor Twirl (Bard)

UCTW17 (нитинол)

Универсальные маркеры для постановки напрямую или через коаксиальную иглу.

Набор для постановки содержит иглу длиной 10 см и диаметром 17 Гейдж имеющую скошенный наконечник для визуализации развёртывания маркера в форме кольца под УЗИ.

Материал маркера – нитинол (никелид титана).

Не содержит полимеров и гелей.

Маркеры Bard предназначены для локализации объекта (новообразования, места биопсии) с целью дальнейшего наблюдения за объектом в молочной железе. Игла из набора оснащена имплантируемым маркером, изготовленным из биомедицинской стали, либо из титана. Размещается под контролем УЗИ, МРТ. Позволяет контролировать ход изменений в отмеченной области.

Форма маркера

RING

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Маркеры Gel Mark UltraCor (Bard)

GMUTC005T (титан) / GMUTC005SS (сталь 316L)

Маркер Gel Mark UltraCor для постановки напрямую или через коаксиальную иглу.

Набор для постановки длиной 10 см и диаметром 14 Гейдж имеет кончик с насечкой для визуализации под УЗИ, и содержит 4 подушечки из молочной и полигликолиевой кислоты и в дистальной позиции один рентгенконтрастный маркер.

Материал маркера – сталь 316L или титан в зависимости от модели.

Подушечки молочной и полигликолиевой кислоты обеспечивают ультразвуковую видимость в течение 4-6 недель, а через 12 недель постепенно растворяются.

Форма маркера	GMUTC005T	GMUTC005SS

Маркеры SenoMark UltraCor MRI (Bard)

SMUCMRI14GT (титан) / SMUCMRI14GSS (сталь 316L)

Универсальные маркеры для постановки напрямую или через коаксиальную иглу.

Набор для постановки длиной 13 см и диаметром 14 Гейдж имеет кончик с насечкой для визуализации под УЗИ, и содержит 3 подушечки из полигликолиевой кислоты и в центре один рентгенконтрастный маркер.

Материал маркера – сталь 316L или титан в зависимости от модели.

Подушечки полигликолиевой кислоты обеспечивают ультразвуковую видимость в течение 3 недель, а через 12 недель постепенно растворяются.

Форма маркера	SMUCMRI14GT	SMUCMRI14GSS

5. Локализаторы

MARK (MDL)

Локализатор опухоли молочной железы предоперационный без возможности репозиции

- Луэр-конус с туннелем для проволоки
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Скользящий маркер для быстрой оценки глубины

Крючок на кончике локализатора доступен в трёх конфигурациях: одинарный; Двойной (буква X в артикуле); Z-образный (буква Z в артикуле).

Таблица доступных к заказу размеров

Крючок	Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	50 мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм
Одинарный	18	1,20	PN1805	PN1807	PN1810	PN1812	PN1815
Одинарный	20	0,90	PN2005	PN2007	PN2010	PN2012	PN2015
Одинарный	21	0,80	PN2105	PN2107	PN2110	PN2112	PN2115
Двойной	18	1,20	PNX1805	PNX1807	PNX1810	PNX1812	PNX1815
Двойной	20	0,90	PNX2005	PNX2007	PNX2010	PNX2012	PNX2015
Z-образный	18	1,20	PNZ1805	PNZ1807	PNZ1810	PNZ1812	PNZ1815
Z-образный	20	0,90	PNZ2005	PNZ2007	PNZ2010	PNZ2012	PNZ2015

Опционально поставляется с утилизатором иглы (буква R в артикуле).

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

MARK SLIM (MDL)

Локализатор опухоли молочной железы предоперационный без возможности репозиции

- Уменьшенные габариты рукояти
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Скользящий маркер для быстрой оценки глубины

Крючок на кончике локализатора доступен в трёх конфигурациях: одинарный; Двойной (буква X в артикуле); Z-образный (буква Z в артикуле).

Таблица доступных к заказу размеров

Крючок	Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	50 мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм
Одинарный	18	1,20	PNS1805	PNS1807	PNS1810	PNS1812	PNS1815
Одинарный	20	0,90	PNS2005	PNS2007	PNS2010	PNS2012	PNS2015
Одинарный	21	0,80	PNS2105	PNS2107	PNS2110	PNS2112	PNS2115
Двойной	18	1,20	PNSX1805	PNSX1807	PNSX1810	PNSX1812	PNSX1815
Двойной	20	0,90	PNSX2005	PNSX2007	PNSX2010	PNSX2012	PNSX2015
Z-образный	18	1,20	PNSZ1805	PNSZ1807	PNSZ1810	PNSZ1812	PNSZ1815
Z-образный	20	0,90	PNSZ2005	PNSZ2007	PNSZ2010	PNSZ2012	PNSZ2015

Опционально поставляется с утилизатором иглы (буква R в артикуле).

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

5. Локализаторы

REPOMARK (MDL)

Локализатор опухоли молочной железы предоперационный репозиционный

- Луэр-конус с туннелем для проволоки
- Сантиметровая маркировка на канюле
- Скользящий маркер для быстрой оценки глубины



Укомплектован проволокой, обладающей памятью материала и имеющий односторонний изогнутый фиксирующий элемент.

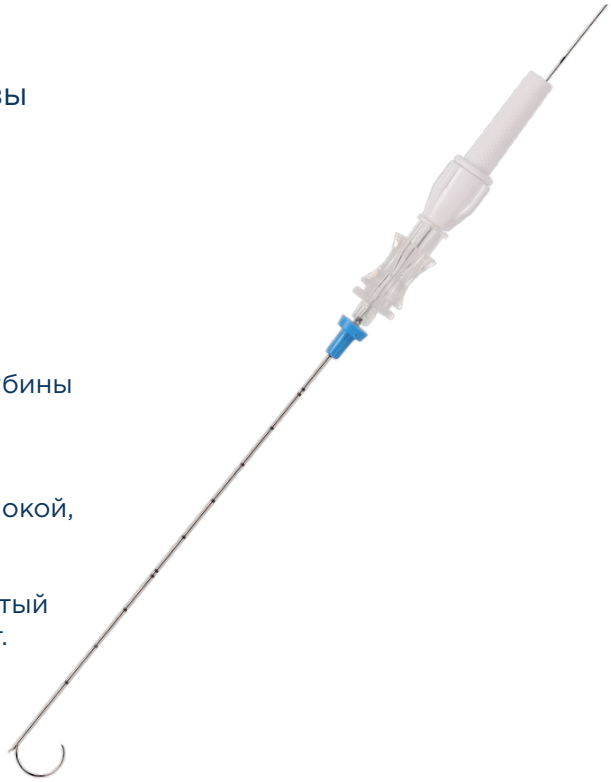

Таблица доступных к заказу размеров

Диаметр, G	Наружный диаметр, мм	50 мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм
20	0,90	PR2005	PR2007	PR2010	PR2012	PR2015

DUALOK (Bard)

Локализационная репозиционная игла-проводник

Предназначена для предоперационной локализации непальпируемых новообразований молочной железы. Размещается под Ренгтен или УЗИ контролем внутри образования, подлежащего удалению, в дальнейшем удаляется вместе с ним. Конструкция иглы гарантирует безопасное и уверенное размещение, легко извлекается в случае необходимости репозиции и может быть установлена повторно. Уникальная конструкция захвата, в виде двойного V-образного крючка, обеспечивает оптимальную фиксацию в тканях и превосходное сопротивление сдвигу.

Доступны иглы диаметром 20 G
и длинами 3.7, 5.7, 7.7, 10.7, 13.7 см.

6. Наборы для галактографии

GALAKIT6

- Шесть диляторов
- Луэр-магистраль
- Шприц объемом 1 мл
- Игла тупоконечная

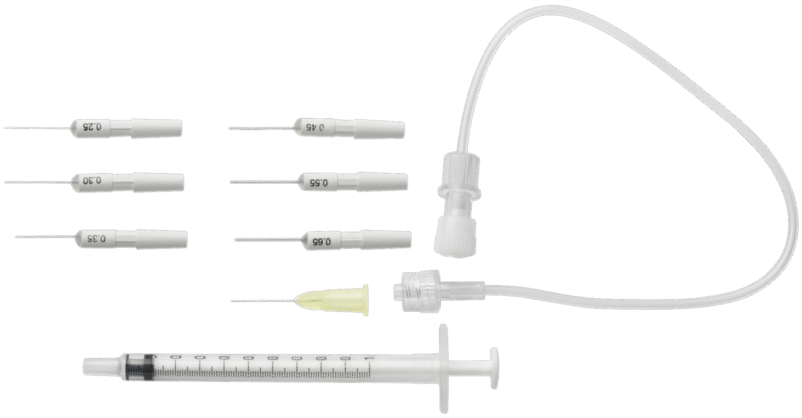

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр, G	Длина, см	Конфигурация
PZZD3015	30	15	прямой
PZZC3015	30	15	изогнутый

GALAKIT Duo

- Два дилятора
- Луэр-магистраль
- Шприц объемом 1 мл
- Игла тупоконечная

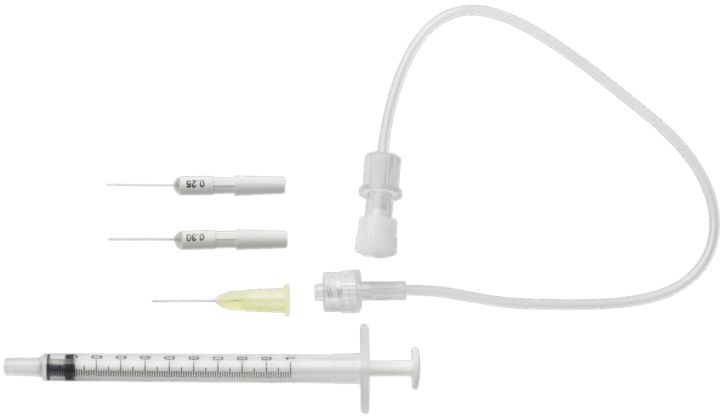

Таблица доступных к заказу размеров

Артикул	Диаметр, G	Длина, см	Конфигурация
PZYD3015	30	15	прямой
PZYC2515	25	15	изогнутый
PZYC3015	30	15	изогнутый

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Метрическая таблица соответствий

Gauge	D, мм	Ch или F	Inches	Gauge	D, мм	Ch или F	Inches
30	0,30	0,9	0,011	17	1,50	4,5	0,059
29	0,33	1,0	0,013	17	1,55	4,65	0,061
28	0,35	1,1	0,014	16	1,60	4,8	0,063
27	0,40	1,2	0,016	16	1,65	4,95	0,064
26	0,45	1,3	0,018	16	1,70	5,1	0,066
25	0,50	1,5	0,020	15	1,80	5,4	0,070
24	0,55	1,6	0,022	15	1,85	5,55	0,072
23	0,65	1,9	0,025	15	1,90	5,7	0,074
22	0,70	2,1	0,028	15	1,95	5,85	0,076
21	0,80	2,4	0,032	15	2,00	6,0	0,078
20	0,90	2,7	0,035	14	2,10	6,3	0,083
19	1,00	3,0	0,042	14	2,20	6,6	0,086
19	1,10	3,3	0,043	14	2,30	6,9	0,090
19	1,15	3,45	0,045	13	2,40	7,2	0,095
18	1,20	3,6	0,047	13	2,50	7,5	0,098
18	1,25	3,75	0,049	13	2,60	7,8	0,100
18	1,30	3,9	0,051	13	2,70	8,1	0,106
18	1,35	4,05	0,053	12	2,80	8,4	0,110
17	1,40	4,2	0,055	12	2,90	8,7	0,114
17	1,45	4,35	0,057	11	3,00	9,0	1,118

АКТИМЕД ПЛЮС

Офис в г. Санкт-Петербург:
пр. Раевского, д. 14, к. 2, оф. 8-Н
+7 (812) 703-50-71

Офис в г. Москва:
ул. Старая Басманная, д. 16/1Б, стр. 6
+7 (495) 231-40-00

8 800 201-20-33 (звонок бесплатный)

www.aktimed.ru
www.biopsyneedle.ru